


操作手册

Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D

在液体中进行接触式电导率测量
Memosens 数字式传感器

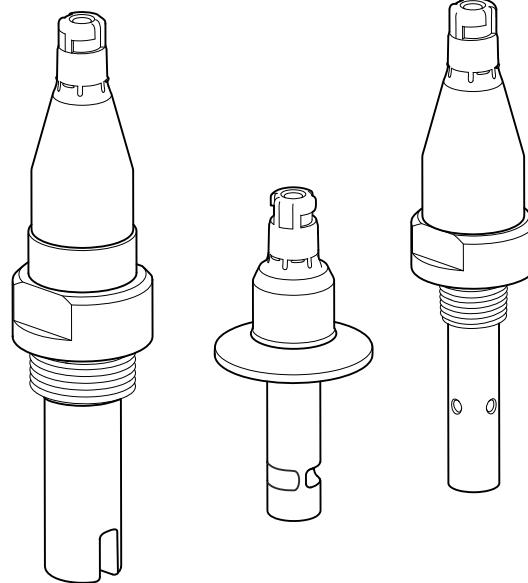

目录

1 文档信息 3

- 1.1 安全图标 3
- 1.2 信息图标 3

2 基本安全指南 4

- 2.1 人员要求 4
- 2.2 指定用途 4
- 2.3 工作场所安全 4
- 2.4 操作安全 4
- 2.5 产品安全 5

3 到货验收和产品标识 7

- 3.1 到货验收 7
- 3.2 产品标识 7
- 3.3 供货清单 8

4 安装 9

- 4.1 安装要求 (仅适用 CLS16D) 9
- 4.2 安装传感器 9
- 4.3 安装后检查 13

5 电气连接 13

- 5.1 快速接线指南 14
- 5.2 连接传感器 15
- 5.3 确保防护等级 16
- 5.4 连接后检查 16

6 调试 17

7 维护 17

8 维修 18

- 8.1 概述 18
- 8.2 备件 18
- 8.3 Endress+Hauser 服务产品 (仅适用 CLS16D) 19
- 8.4 返厂 19
- 8.5 废弃 19

9 技术参数 20

- 9.1 输入 20
- 9.2 性能参数 20
- 9.3 环境条件 21
- 9.4 过程条件 22
- 9.5 机械结构 24

1 文档信息

1.1 安全图标

安全信息结构	说明
▲ 危险 原因(/后续动作) 疏略安全信息的后续动作 ▶ 校正动作	危险状况警示。 疏忽会导致人员死亡或严重伤害。
▲ 警告 原因(/后续动作) 疏略安全信息的后续动作 ▶ 校正动作	危险状况警示。 疏忽可能导致人员死亡或严重伤害。
▲ 小心 原因(/后续动作) 疏略安全信息的后续动作 ▶ 校正动作	危险状况警示。 疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
注意 原因/状况 疏略安全信息的后续动作 ▶ 动作/提示	疏忽可能导致财产和设备损坏。

1.2 信息图标

-  附加信息, 提示
-  允许或推荐的操作
-  禁止或不推荐的操作
-  参见设备文档
-  参考页面
-  参考图
-  操作结果

2 基本安全指南

2.1 人员要求

- 仅允许经培训的专业技术人员进行测量系统的安装、调试、操作和维护。
- 执行特定操作的技术人员必须经工厂授权。
- 仅允许电工进行设备的电气连接。
- 技术人员必须阅读《操作手册》，理解并遵守其中的各项规定。
- 仅允许经专业培训的授权人员进行测量点故障排除。

 仅允许制造商或其服务机构直接进行《操作手册》中未描述的维修操作。

2.2 指定用途

电导率传感器在液体介质中进行电导式电导率测量。

适合下列应用场合：

传感器型号	应用场合	危险区应用
Condumax CLS15 D	(超) 纯水测量	防爆 0 区
Condumax CLS16 D	卫生应用场合中的 (超) 纯水测量	防爆 0 区
Condumax CLS21 D	中-高电导率介质的测量	防爆 0 区

除本文档指定用途外，其他任何用途均有可能对人员和整个测量系统的安全造成威胁，禁止使用。

由于不恰当使用，或用于非指定用途而导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

2.3 工作场所安全

用户有责任且必须遵守下列安全标准的要求：

- 安装指南
- 地方标准和法规
- 防爆保护法规

电磁兼容性

- 产品通过电磁兼容性 (EMC) 测试，符合国际工业应用的适用标准要求。
- 仅完全按照本《操作手册》说明进行接线的产品才符合电磁兼容性 (EMC) 要求。

2.4 操作安全

在进行整个测量点调试之前：

1. 检查并确认所有连接均正确。
2. 确保电缆和软管连接无损坏。
3. 禁止使用已损坏的产品，并采取保护措施避免误操作。
4. 将产品标识为故障产品。

在操作过程中:

- ▶ 如果故障无法修复:
产品必须停用，并采取保护措施避免误操作。

2.5 产品安全

2.5.1 先进技术

产品设计符合最严格的安全要求，通过出厂测试，可以安全工作。必须遵守相关法规和国际标准的要求。

2.5.2 在危险区中使用的电气设备

ATEX/NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

- Memosens 感应式传感器电缆连接系统可以在危险区中使用，符合 EC 型式认证 BVS 04 ATEX E 121 X。相关 EC 一致性声明是《操作手册》的组成部分。
- 防爆型电导率传感器 CLS15D、CLS16D、CLS21D 只能通过测量电缆 CYK10-G/I***连接至变送器 Liquiline M CM42-KE/F/G/I/J*****的本安认证型数字式传感器输出回路，符合 EC 型式认证 TÜV 13 ATEX 7459 X。
- 必须按照变送器的接线图进行电气连接。
- 金属过程连接部件必须安装在静电导电的位置处(< 1 MΩ)。
- 带非金属过程连接的 CLS15D 传感器和 CLS21D 传感器仅可在电导率不小于 10 nS/cm 的液体中测量。
- 带非金属过程连接的 CLS15D 传感器不能在存在静电释放的过程条件下使用，特别是在外电极电气隔离的过程条件下使用。
- 在防爆 0 区中使用时，测量电缆 CYK10-G/I***及其接线盒必须采取静电荷放电防护措施。
- 最大允许电缆长度为 100 m。
- 防爆型 Memosens 数字式传感器带桔红色环。
- 使用仪表和传感器时必须完全遵守危险区中电气系统的使用法规(例如: EN/IEC 60079-14)。

温度等级

名称	型号					温度等级(Tn)对应的介质温度 Ta	防爆保护
Condumax	CLS15D	-	A	**	G	-20 °C ≤ Ta ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ Ta ≤ +120 °C (T4) -20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C (T6)	II 1G
Condumax	CLS15D	-	B/L	**	G	-20 °C ≤ Ta ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ Ta ≤ +100 °C (T4) -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C (T6)	II 1G

名称	型号	温度等级(Tn)对应的介质温度 T_a				防爆保护。
Condumax	CLS16D	-	**	**	G	-5 °C ≤ T_a ≤ +135 °C (T3) -5 °C ≤ T_a ≤ +115 °C (T4) -5 °C ≤ T_a ≤ +65 °C (T6)
Condumax	CLS21D	-	*	**	G	-20 °C ≤ T_a ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ T_a ≤ +115 °C (T4) -20 °C ≤ T_a ≤ +65 °C (T6)

在指定介质温度范围内使用时，温度始终与温度等级对应。

ATEX/NEPSI II 3G Ex ic IIC T3/T4/T6 Gc

- Memosens 感应式传感器连接系统可以在 2 区防爆场合中使用。相关 EU 一致性声明是《操作手册》的组成部分。
- 防爆型 CLS15D、CLS16D、CLS21D 只能通过测量电缆 CYK10-V****连接至变送器 Liquiline M CM42-KV*****的本安认证型数字式传感器输出回路。
- 必须按照变送器的接线图进行电气连接。
- 金属过程连接部件必须安装在静电导电位置处($< 1 \text{ M}\Omega$)。
- 带非金属过程连接的 CLS15D 传感器和 CLS21D 传感器仅可在电导率不小于 10 nS/cm 的液体中测量。
- 带非金属过程连接的 CLS15D 传感器不能在存在传感器静电释放的过程条件下使用，特别是在外电极电气隔离的过程条件下使用。
- 最大允许电缆长度为 100 m。
- 使用仪表和传感器时必须完全遵守危险区中电气系统的使用法规(例如：EN/IEC 60079-14)。

温度等级

名称	型号	温度等级 Tn 对应的介质温度 T_a				防爆等级
Condumax	CLS15D	-	A	**	V	-20 °C ≤ T_a ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ T_a ≤ +120 °C (T4) -20 °C ≤ T_a ≤ +70 °C (T6)
Condumax	CLS15D	-	B/L	**	V	-20 °C ≤ T_a ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ T_a ≤ +100 °C (T4) -20 °C ≤ T_a ≤ +50 °C (T6)
Condumax	CLS16D	-	**	**	V	-5 °C ≤ T_a ≤ +135 °C (T3) -5 °C ≤ T_a ≤ +115 °C (T4) -5 °C ≤ T_a ≤ +65 °C (T6)
Condumax	CLS21D	-	*	**	V	-20 °C ≤ T_a ≤ +135 °C (T3) -20 °C ≤ T_a ≤ +115 °C (T4) -20 °C ≤ T_a ≤ +65 °C (T6)

在指定介质温度范围内操作时，设备温度始终与温度等级对应。

FM/CSA IS/NI Cl.1 Div.1&2 Gr. A-D

- ▶ 注意变送器的配套文档资料和控制图示。

3 到货验收和产品标识

3.1 到货验收

1. 检查并确认外包装完好无损。
 - ↳ 如存在外包装破损, 请立即告知供应商。
在事情尚未解决之前, 务必妥善保管外包装。
2. 检查并确认包装内的物品完好无损。
 - ↳ 如物品已被损坏, 请立即告知供应商。
在事情尚未解决之前, 务必妥善保管物品。
3. 检查订单的完整性, 确保与供货清单完全一致。
 - ↳ 比对供货清单和订单。
4. 使用抗冲击和防潮包装存放和运输产品。
 - ↳ 原包装具有最佳防护效果。
必须符合环境条件的指定要求。

如有任何疑问, 请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

3.2 产品标识

3.2.1 防爆型传感器的订货号

名称	型号	选型代号		
Condumax	CLS15D	-	*	**
	CLS16D	-	**	**
	CLS21D	-	*	**
		过程连接/材料, 非防爆参数		可以在危险区、ATEX/NEPSI II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga、IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga 防爆场合中使用

名称	型号	选型代号		
Condumax	CLS15D	-	*	**
	CLS16D	-	**	**
	CLS21D	-	*	**
		过程连接/材料, 非防爆参数		可以在危险区、FM/CSA IS/NI CI I Div.1&2 Gr. A-D 防爆场合中使用

名称	型号	选型代号		
Condumax	CLS15D	-	*	**
	CLS16D	-	**	**
	CLS21D	-	*	**
		过程连接/材料, 非防爆参数		可以在危险区、ATEX/NEPSI II 3G Ex ic IIC T3/T4/T6 Gc 防爆场合中使用

3.2.2 铭牌

铭牌上提供下列设备信息：

- 制造商名称
- 扩展订货号
- 序列号
- 安全图标和警告图标

► 逐一比对铭牌和订货单，确保信息一致。

3.2.3 产品标识

产品主页

www.endress.com/cls15d

www.endress.com/cls16d

www.endress.com/cls21d

订货号说明

下列位置处标识有产品订货号和序列号：

- 铭牌上
- 供货清单上

查询产品信息

1. 登陆公司网站 www.endress.com。
2. 在搜索页面（带放大镜图标）中输入有效序列号。
3. 进行搜索（点击放大镜图标）。
↳ 弹出窗口中显示产品列表。
4. 点击产品概览。
↳ 显示新窗口。输入设备信息，包括产品文档资料代号。

制造商地址

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24

D-70839 Gerlingen

3.3 供货清单

供货清单如下：

- 传感器
- 《操作手册》

4 安装


4.1 安装要求 (仅适用 CLS16D)

- ▶ EHEDG 标准规定, 安装仪表时必须避免卫生死角, 确保满足易清洗要求。
- ▶ 如果不能避免卫生死角, 应尽量缩短其长度。任何情况下, 卫生死角长度 L 均不得超过管道内径 D 与设备周径 d 的差值 ($L \leq D - d$)。
- ▶ 此外, 卫生死角部位必须能够自排空, 确保介质或过程流体不会积聚。
- ▶ 安装在罐体中时, 清洗装置必须能够直接冲洗卫生死角。
- ▶ 详细信息参见 EHEDG 指南文件 10 中规定的卫生型密封圈和安装指南要求, 以及“易清洗管道接头和过程连接”书面要求。

4.2 安装传感器

4.2.1 CLS15D

通过 NPT $\frac{1}{2}$ " 或 $\frac{3}{4}$ " 螺纹或 $1\frac{1}{2}$ " 卡箍过程连接直接安装传感器。此外, 传感器还可以安装在三通或四通等通用管件上, 或安装在流通式安装支架中使用。

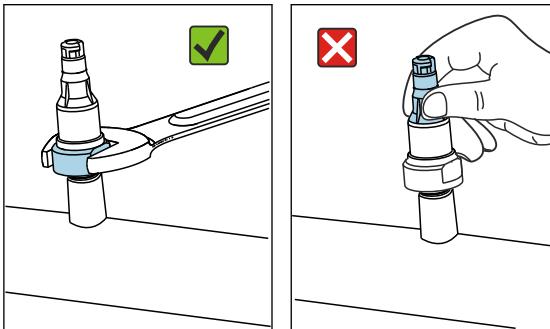


注意

拆装错误!

Memosens 头会松动和掉落, 导致传感器整体故障!


- ▶ 只允许通过过程连接安装传感器。
- ▶ 使用合适工具安装, 例如开口扳手。

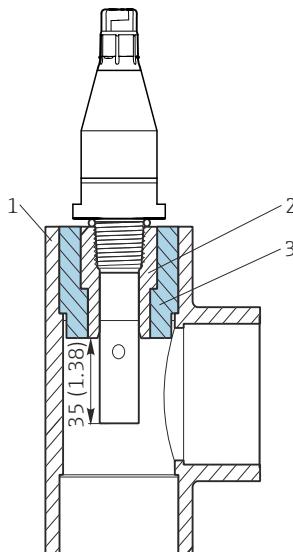

A0019015

图 1 NPT $\frac{1}{2}$ "螺纹连接, 安装在三通或四通上。测量单位 mm (in)

- 1 三通或四通 (DN 32、DN 40 或 DN 50)
- 2 粘合性 VC 螺纹接头 (NPT $\frac{1}{2}$ "螺纹适用管径 DN 20)
- 3 粘合性适配接头 (适用管径 DN 32、DN 40、DN 50)

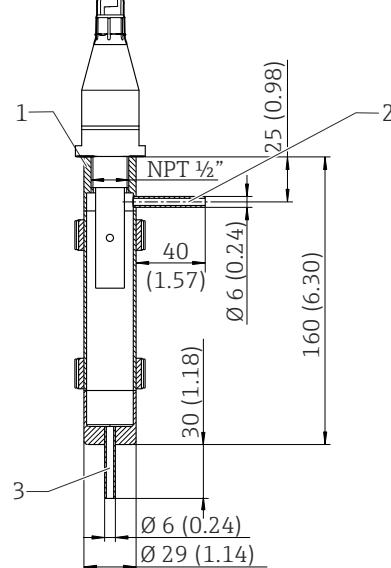

A0047263

图 2 NPT $\frac{1}{2}$ "螺纹连接, 安装在流通式安装支架 CYA21 中。测量单位 mm (in)

- 1 NPT $\frac{1}{2}$ "传感器安装座
- 2 进水口
- 3 出水口

1. 在测量过程中传感器电极必须完全插入介质中。插入深度不得小于 35 mm (1.38")。


2. 使用传感器测量超纯水时, 必须确保在抽空条件下执行。

→ 否则, 空气中的 CO₂ 会溶解在超纯水中, 发生 (微弱) 水解, 导致电导率上升, 最大增加 3 μ S/cm。

4.2.2 CLS16D


通过过程连接直接安装传感器。

- ▶ 在管道中安装传感器时，注意介质流向。

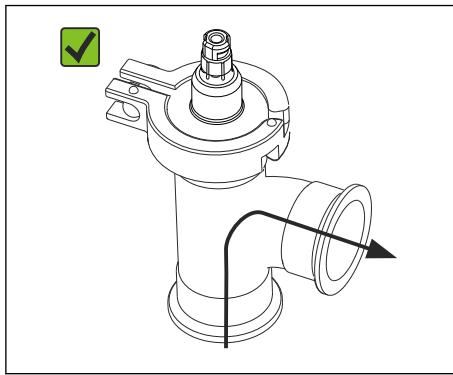

A0019016

图 3 允许流向

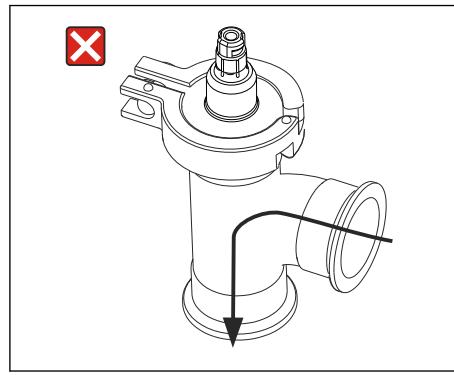

A0019017

图 4 禁止流向

1. 在测量过程中电极必须完全浸没在介质中。
2. 传感器进行超纯水测量时，必须在真空条件下工作。
 - ↳ 否则空气中的 CO₂ 会溶解在水中，微量二氧化碳就会导致电导率增大，最多可以增加 3 μS/cm。


4.2.3 CLS21D



卡箍连接

可以使用金属钢板支架和实心钢支架固定传感器。属钢板具有较差的机械稳定性，非均匀承载表面产生点负载，可能损坏卡箍的尖锐边缘。建议使用实心钢支架，因为其具有较好的机械稳定性。实心钢支架可以在整个压力/温度范围内使用(参考压力-温度曲线)。

通过过程连接直接安装传感器。此外，传感器还可以安装在流通式安装支架中。

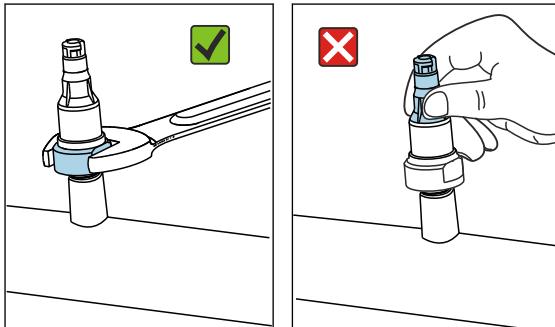

注意

拆装错误！

Memosens 头会松动和掉落，导致传感器整体故障！

- ▶ 只允许通过过程连接安装传感器。
- ▶ 使用合适工具安装，例如开口扳手。

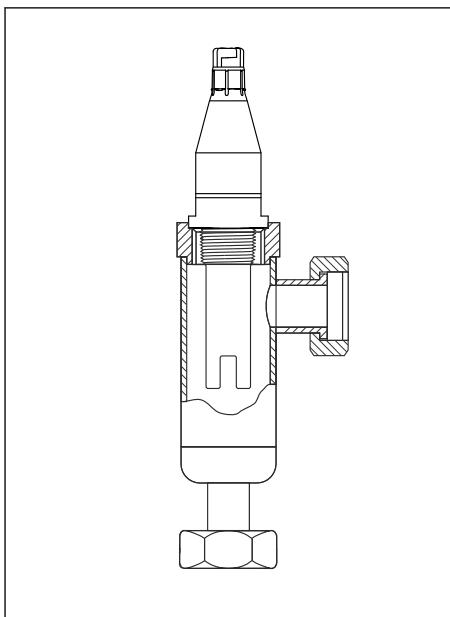


图 5 安装在流通式安装支架 CLA751 中


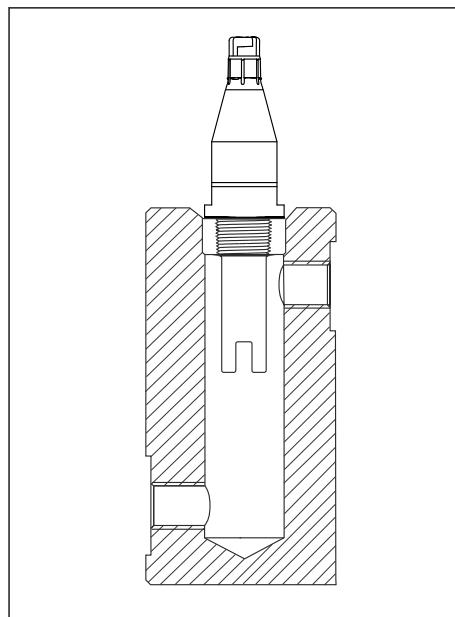


图 6 安装在流通式安装支架 CLA752 中

带 G1 螺纹连接的传感器通过浸入式安装支架 Dipfit CLA111 可以直接安装在罐体上。

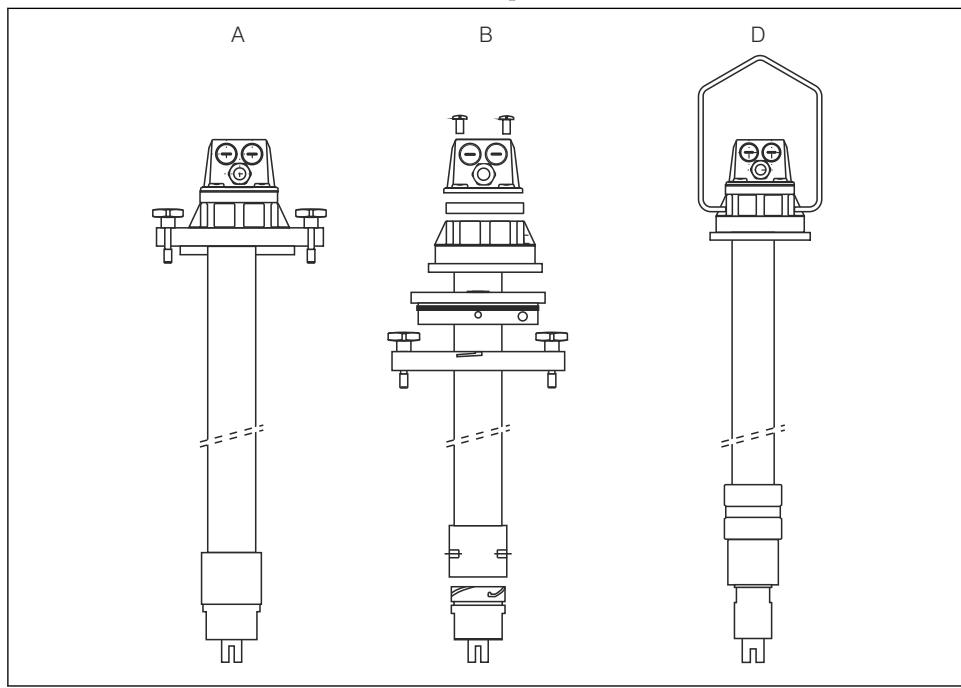

A0024145

图 7 安装在浸入式安装支架 Dipfit CLA111 中 (安装方式 A、B 和 D)

i 在测量过程中传感器电极必须完全插入介质中。

4.3 安装后检查

1. 传感器和电缆是否完好无损？
2. 传感器是否已正确安装在过程连接中，没有自由悬挂在电缆上？

5 电气连接

⚠ 警告


仪表带电

接线错误可能导致人员伤亡！

- ▶ 仅允许认证电工执行电气连接操作。
- ▶ 电工必须事先阅读《操作手册》，理解并遵守其中的各项规定。
- ▶ 进行任何接线操作之前，必须确保所有电缆均不带电。

5.1 快速接线指南

5.1.1 在防爆 0 区中安装传感器

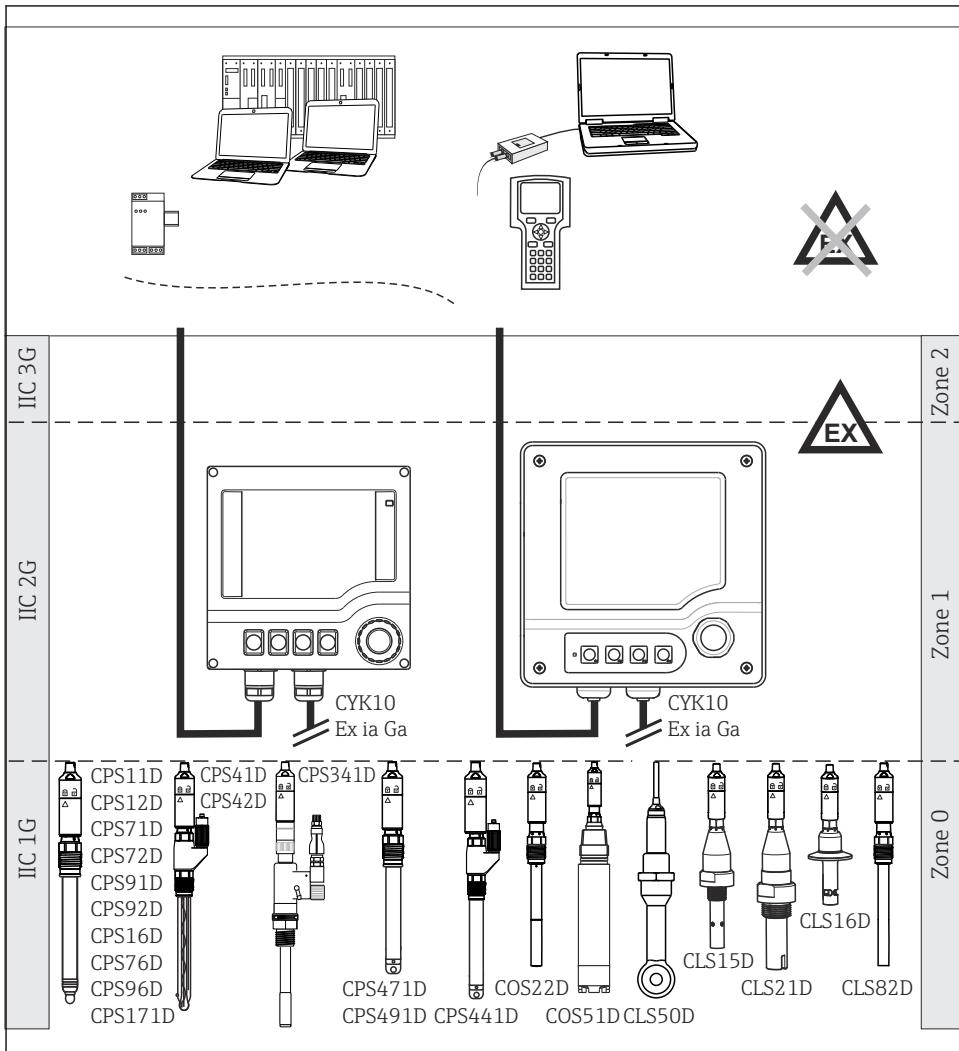

A0031174

图 8 危险区中的电气连接

5.1.2 在防爆 2 区中安装传感器

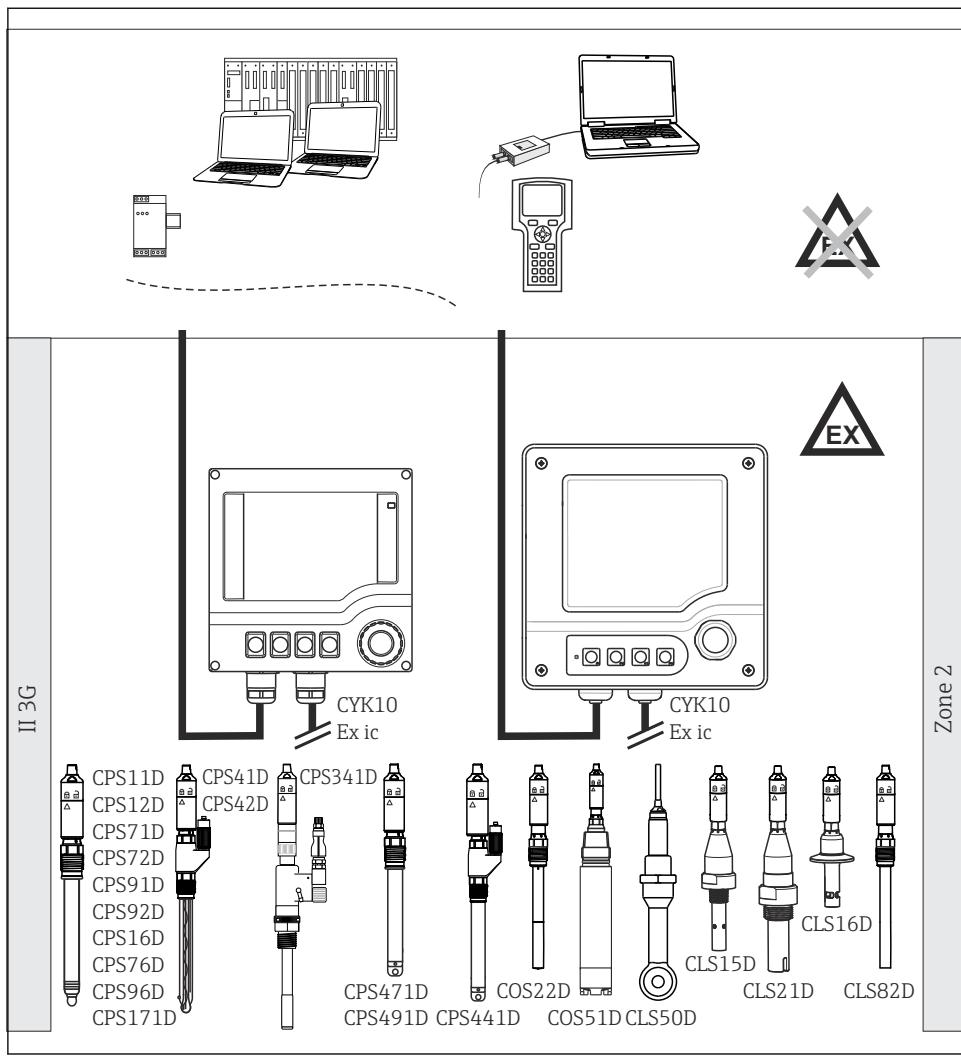


图 9 危险区中的电气连接

5.2 连接传感器

使用 Memosens 电缆 CYK10 连接电极和变送器。

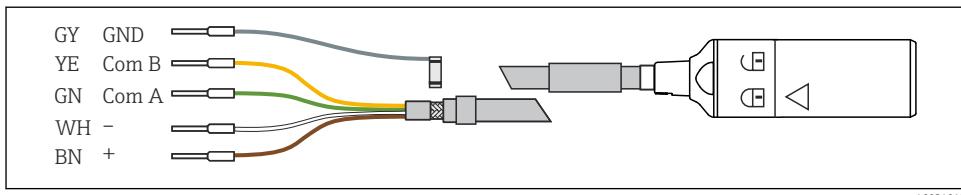


图 10 Memosens 电缆 CYK10

注意

CLS15D 和 CLS21D 防机械缠绕保护

过度用力拧紧 Memosens 接头会损坏连接，导致传感器损坏！

- ▶ 将传感器连接至电缆接头时，无需过度用力。小心操作！
- ▶ 如果 Memosens 接头明显未闭合，检查接头是否洁净或是否存在机械损坏，并保证旋转方向正确。注意接头上的锁扣图标！
- ▶ 如需要，使用其他 Memosens 电缆。

5.3 确保防护等级

仅进行本《操作手册》明确允许的必须机械和电气连接，仪表可以在出厂前完成接线。

- ▶ 操作时需要特别注意。

否则无法保证产品各种防护功能（防护等级（IP）、电气安全性、EMC 抗干扰能力）；例如盖板掉落或电缆末端松动。

5.4 连接后检查

设备状况和规格参数	操作
传感器，安装支架或电缆是否完好无损？	▶ 进行外观检查。
电气连接	操作
安装后的电缆是否不受外力的影响，并且无缠绕？	▶ 进行外观检查。 ▶ 保证电缆不打结。
电缆线芯的去皮长度是否足够，且已正确固定安装在接线端子中？	▶ 进行外观检查。 ▶ 轻拉，检查是否正确安装到位。
所有螺丝端子是否均已牢固拧紧？	▶ 拧紧螺丝端子。
所有电缆入口是否均已安装、拧紧和密封？	▶ 进行外观检查。
所有电缆入口是否均朝下或侧向放置？	使用横向电缆入口时： ▶ 电缆回路必须朝下，以便水可以滴落。

6 调试

首次上电调试仪表前，务必确保：

- 传感器已正确安装就位
- 传感器已正确完成接线

1. 在变送器上检查温度补偿设置和阻尼时间设置。

 如果传感器与 Liquiline CM44x 或 CM44xR 变送器搭配使用，参见变送器的《操作手册》（例如 BA01245C）。

▲ 警告

过程介质泄漏

存在高压、高温或化学危险品导致人员受伤的风险！

- 带清洗系统的安装支架在加压前，务必确保系统的所有连接均正确。
- 如果无法保证连接正确，禁止将安装支架移动至过程中。

使用带自动清洗功能的安装支架时：

2. 检查并确保正确接入清洗介质（例如水或空气）。

3. 完成调试后：

定期维护传感器。

↳ 确保测量结果始终可靠。

仅适用 CLS15D：



传感器可以在标称压力大于 1 bar (15 psi) 的工况下使用，通过加拿大 CRN 认证，符合 CSA B51 标准要求（“锅炉、压力容器和管道规范”；F 类）。

铭牌上标识有加拿大 CRN 认证号。

7 维护

▲ 小心

强腐蚀的化学药剂

存在化学药剂烧伤眼睛和皮肤的风险，以及损坏衣服和设备的风险！

- 进行酸液、碱液和有机溶剂操作时，必须采取防护措施保护眼睛和手。
- 佩戴护目镜和防护手套。
- 清洗溅洒至衣服和其他物品上化学药剂，防止任何损坏。
- 遵守化学药剂安全数据表中的说明操作。

▲ 警告

硫脲

吞食有害。尚无充分证据证明硫脲致癌。可能对胎儿有害。长期危害环境。

- 佩戴护目镜和防护手套，并穿着合适的防护服。
- 禁止接触眼睛、口腔和皮肤。
- 禁止直接排放至环境中。



强腐蚀的化学药剂

存在化学药剂烧伤眼睛和皮肤的风险，以及损坏衣服和设备的风险！

- ▶ 进行酸液、碱液和有机溶剂操作时，必须采取防护措施保护眼睛和手。
- ▶ 佩带护目镜和防护手套。
- ▶ 清洗溅洒至衣服和其他物品上化学药剂，防止任何损坏。
- ▶ 遵守化学药剂安全数据表中的说明操作。

参照以下说明分类清除传感器上的污染粘附物：

1. 油层和油脂层：

使用除油脂剂（例如酒精）清洗；也可以使用热水和含表面活性剂的（碱性）清洗剂（例如洗洁精）清洗。

2. 石灰石、金属氢氧化物粘附和难溶性有机粘附：

使用稀盐酸（3%）溶解粘附，随后使用大量清水彻底进行清洗。

3. 硫化物粘附（烟气脱硫或污水处理厂排放）：

使用盐酸（3%）和硫脲（市售）混合液溶解粘附，随后使用大量清水彻底进行清洗。

4. 蛋白质粘附（如在食品行业中）：

使用盐酸（0.5%）和胃蛋白酶（市售）混合液溶解粘附，随后使用大量清水彻底进行清洗。

5. 易溶性生物粘附：

首先，使用加压水冲洗。

随后，使用大量清水彻底进行清洗。

8 维修

8.1 概述

维修和改装概念提供以下内容：

- 产品采用模块化结构
- 备件被分组为套件，其中包括相关套件说明
- 仅使用制造商的原装备件
- 维修工作由制造商服务部门或经过培训的用户执行
- 仅允许制造商服务部门或在工厂中将认证设备改装成其他型号的认证设备
- 遵守适用标准、国家法规、防爆手册（XA）和证书要求

1. 按照套件说明进行修理。

2. 记录维修和改装工作，并在生命周期管理工具（W@M）中输入（或已经输入）。

8.2 备件

目前有货的设备备件可通过网站订购：

www.endress.com/device-viewer

- ▶ 订购备件时请注明设备序列号。

8.3 Endress+Hauser 服务产品 (仅适用 CLS16D)

密封圈完好无损是安全可靠测量的首要条件。定期更换密封圈，确保传感器具有最高操作安全性和卫生性。

用户确定实际间隔时间，主要取决于操作条件，例如：

- 介质类型和温度
- 清洗剂类型和温度
- 清洗次数
- 蒸汽消毒次数
- 操作条件

推荐密封圈更换间隔时间(参考值)

应用	推荐间隔时间
介质温度范围: 50...100 °C (122...212 °F)	约 18 个月
介质温度: < 50 °C (122 °F)	约 36 个月
蒸汽消毒次数(max. 150 °C (302 °F), 在 45 分钟内)	约 400 次

为了确保已在极高负荷下工作的传感器能够重新正常测量，需要返厂再生。在返厂传感器上安装新密封圈，并重新进行传感器标定。

更换密封圈和返厂重新标定的详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

8.4 返厂

产品需维修或进行工厂标定、订购型号错误或发货错误时，必须返厂。Endress+Hauser 是 ISO 认证企业，依据相关法规规定的特定程序进行接液产品的处置。

为了能够快速、安全且专业地进行设备返厂：

- ▶ 参照网站 www.endress.com/support/return-material 上提供的设备返厂步骤和条件说明。

8.5 废弃



为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。带此标志的产品不能列入未分类的城市垃圾处理。在满足适用条件的前提下，返厂报废。

9 技术参数

9.1 输入

9.1.1 测量变量

- 电导率
- 温度

9.1.2 测量范围

电导率	(测量条件: 水, 25 °C (77 °F))
CLS15D -A	0.04...20 µS/cm
CLS15D -B/L	0.10...200 µS/cm
CLS16D	0.04...500 µS/cm
CLS21D	10 µS/cm...20 mS/cm
温度	
CLS15D	-20...100 °C (-4...212 °F)
CLS16D	-5...100 °C (23...212 °F)
CLS21D	-20...100 °C (-4...212 °F)

9.1.3 电极常数

CLS15D -A	$k = 0.01 \text{ cm}^{-1}$
CLS15D -B/L	$k = 0.1 \text{ cm}^{-1}$
CLS16D	$k = 0.1 \text{ cm}^{-1}$
CLS21D	$k = 1.0 \text{ cm}^{-1}$ (标称值)

9.1.4 温度补偿

NTC 30K

9.2 性能参数

9.2.1 测量不确定度

CLS15D

每支传感器在工厂中都在约 5 µS/cm 的溶液中 (电极常数为 0.01 cm^{-1}) 或约 50 µS/cm 的溶液中 (电极常数为 0.1 cm^{-1}) 中标定, 使用的参比测量系统符合 NIST 或 PTB 溯源认证。制造商提供的质量证书上标识有精确电极常数值。确定电极常数的测量误差为 1.0 %。

CLS16D

每支传感器在工厂中都在约 5 µS/cm 的溶液中标定, 使用的参比测量系统符合 NIST 或 PTB 溯源认证。制造商提供的质量证书上标识有精确电极常数值。确定电极常数的测量误差为 1.0 %。

CLS21D

每支传感器在工厂中都在约 5 mS/cm 的溶液中标定，使用的参比测量系统符合 NIST 或 PTB 溯源认证。制造商提供的质量证书上标识有精确电极常数值。确定电极常数的测量误差为 1.0 %。

9.2.2 响应时间

电导率	$t_{95} \leq 3$ 秒
温度	
CLS15D-A	$t_{90} \leq 39$ 秒
CLS15D-B/L	$t_{90} \leq 17$ 秒
CLS16D	$t_{90} \leq 13$ 秒
CLS21D	$t_{90} \leq 296$ 秒

9.2.3 最大测量误差

CLS15D	读数值的 2%
CLS16D	读数值的 2%, 最大 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
CLS21D	读数值的 3%, 200...500 $\mu\text{S}/\text{cm}$

9.2.4 重复性

读数值的 2%

9.3 环境条件

9.3.1 环境温度范围

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

9.3.2 储存温度范围

-25...+80 °C (-10...+180 °F)

9.3.3 防护等级

IP 68 / NEMA type 6P (1 m 水柱, 25 °C, 24 h)

9.4 过程条件

9.4.1 过程温度

CLS15D

正常操作	-20...120 °C (-4...248 °F)
消毒 (不超过 1 小时) ¹⁾	最高 140 °C (284 °F)

CLS16D

正常操作	-5...120 °C (23...248 °F)
消毒 (不超过 45 分钟)	最大 150 bar (87 psi), 绝压, 6 °C (302 °F) 时

CLS21D

	-20...135 bar (-4...275 psi), 绝压, 3.5 °C (50 °F) 时
--	--

1) 螺纹连接型: 不超过 30 分钟

 与变送器通信的最高温度为 130 °C (266 °F), 适用于 Memosens 数字式传感器。

9.4.2 过程压力

CLS15D

13 bar (188 psi), 绝压, 20 °C (68 °F) 时
2 bar (29 psi), 绝压, 120 °C (248 °F) 时

CLS16D

13 bar (188 psi), 绝压, 20 °C (68 °F) 时
9 bar (130 psi), 绝压, 120 °C (248 °F) 时
0.1 bar (1.5 psi), 绝压 (负压), 20 °C (68 °F) 时

CLS21D

17 bar (246 psi), 绝压, 20 °C (68 °F) 时

9.4.3 温压曲线

CLS15D

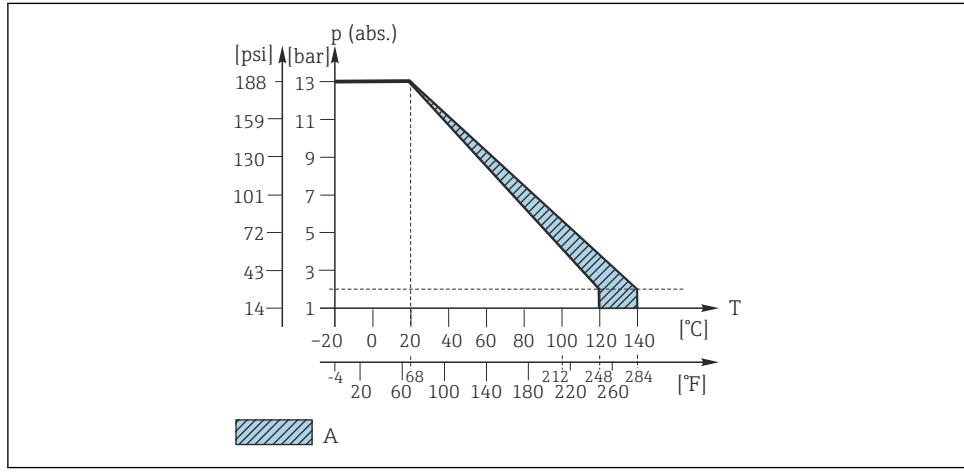


图 11 温压曲线

A 允许短时间高温消毒（不超过 1 小时）

CLS16D

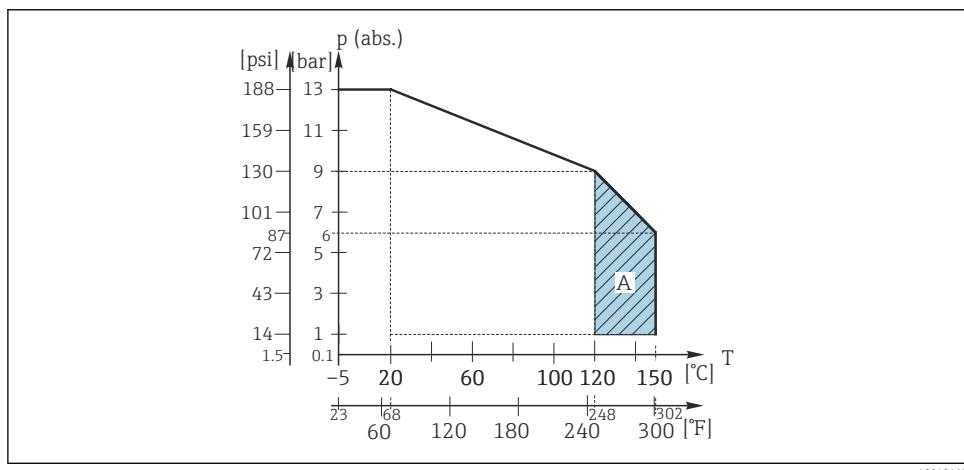
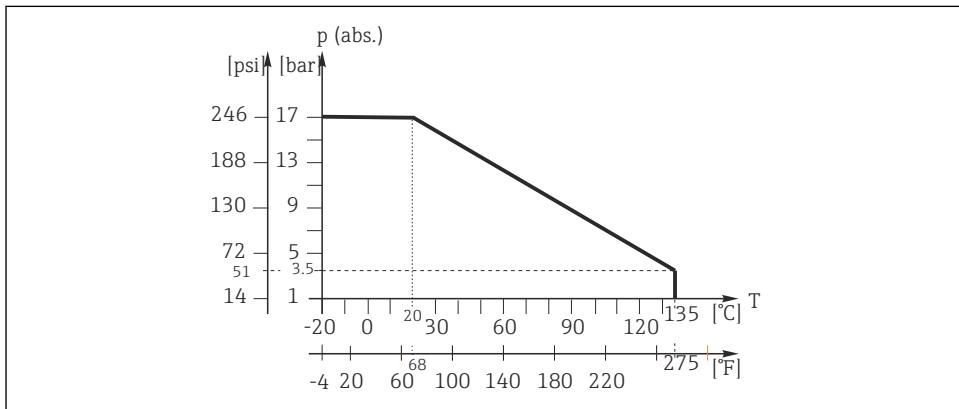


图 12 温压曲线

A 允许短时间高温消毒（不超过 45 分钟）

CLS21D

A0049161

图 13 温压曲线

9.5 机械结构**9.5.1 重量****CLS15D 和 CLS21D**

约 0.3 kg (0.66 lbs), 取决于型号

CLS16D

约 0.13...0.75 kg (0.29...1.65 lbs), 取决于型号

9.5.2**CLS15D**

电极	不锈钢 1.4435 (AISI 316L), 表面抛光处理
传感器杆	聚砜塑料 (PES-GF20)
O 型圈, 直接接液 (卡箍专用)	EPDM

CLS16D

电极	不锈钢 1.4435 (AISI 316L), 电抛光处理
密封圈	ISOLAST (FFKM), FDA 认证

CLS21D

电极	石墨
传感器杆	聚砜塑料 (PES-GF20)
温度探头的导热槽	钛 3.7035
卡箍过程连接	
■ 过程连接	■ 不锈钢 1.4435
■ 密封圈	■ EPDM

9.5.3 过程连接**CLS15D**

NPT 1/2"和3/4"螺纹
1½"卡箍, 符合 ISO 2852 标准

CLS16D

1"、1½"、2"卡箍, 符合 ISO 2852 标准 (同样适用 TRI-CLAMP、DIN 32676)
Tuchenhagen VARIVENT N DN 50...125
NEUMO BioControl D50

CLS21D

G1 螺纹
NPT 1"螺纹
2"卡箍, 符合 ISO 2852 标准
卫生型接头 DN 25 和 DN 40, 符合 DIN 11851 标准

9.5.4 表面光洁度 (适用型号: CLS15D、CLS16D)**CLS15D**

$R_a \leq 0.8 \mu\text{m}$

CLS16D

$R_a \leq 0.8 \mu\text{m}$, 电抛光
 $R_a \leq 0.38 \mu\text{m}$, 电抛光, 可选



71573710

中国E+H技术销售www.ainSTRU.com
电话：0755-82221901
邮箱：sales@ainSTRU.com